

Bruksanvisning/Manual



Miniflex Classic, modell 591-33
Flexmobil Classic, modell 691-33



Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	2
Inledning	3
Kontakt	3
Montering	4
Transport	4
Säkerhetsföreskrifter	5
Översikt	6
Elektronik	7
Ryggstöd - sittdjup, vinkel	8
Ryggstöd - höjd	9
Sitsvinkel - manuell	10
Sitsvinkel - el	11
Sitshöjd	12
Armstöd - höjd, bredd, fälla bakåt .	13
Manöverbox - justera	14
Nackstöd - justera	15
Benstöd - hel fotplatta, delade	16
Körning	17
Frikoppling av bromsar	18
Automatsäkring	19
Laddning av batterier	20
Service	21
Garanti	21
CE-märkning	21
Rengöring	22
Funktion	22
Förvaring	22
Teknisk data	23
Felsökning	24

CONTENTS

Contents	2
Introduction	3
Contact	3
Assembly	4
Transportation	4
Safety	5
Over view	6
Electronics	7
Back rest - seat depth, angle	8
Back rest - height	9
Seat angle - manual	10
Seat angle - power	11
Seat height	12
Arm rest - height, width, fold back	13
Controlbox - adjustment	14
Neckrest	15
Leg rest - devided footplate	16
Driving	17
Disengagement	18
Automatic Fuse	19
Charging of batteries	20
Service	21
Warranty	21
CE-label	21
Cleaning	22
Function	22
Storage	22
Technical date	23
Fault trace	24

INLEDNING

Vi gratulerar till ert val av Miniflex/Flexmobil Classic elrullstol! Vi hoppas ni kommer att bli nöjd med denna Euroflex produkt från Eurovema AB, som är konstruerad och byggd i Gislaved, Sverige. Miniflex/Flexmobil är konstruerad för att tillgodose mycket höga krav på ergonomi, sittkomfort och funktion. Elrullstolen är avsedd för personer med funktionshinder och som sitter mycket och länge i sin stol. Elrullstolen har en mängd inställningsmöjligheter för att kunna anpassas efter varje behov. Läs igenom bruksanvisningen noga för att kunna tillgodogöra er elrullstols alla möjligheter.

KONTAKT

Har ni frågor eller behöver hjälp med er produkt kontaktas i första hand den lokala leverantören (Hjälpmiddelscentral). För att komma i kontakt med tillverkaren se information nedan:

Eurovema AB
Tel: +46 371 390 100
Fax: +46 371 189 82
E-post: info@eurovema.se
Baldersvägen 38
SE-332 35 Gislaved
Sverige
www.eurovema.se

INTRODUCTION

We congratulate you to the choice of powerchair. We hope you will be satisfied with this product from Eurovema AB, constructed and build in Gislaved, Sweden. Miniflex/Flexmobil is developed to meet very high demands on comfort and function. The powerchair is suitable for disabled people and for those who spend a lot of time in their chair. The chair is fully adjustable in order to meet all the needs for adaptation. Read the manual carefully before use.

CONTACT

If you have questions or need help with your product, please contact the local agent. To get in touch with the manufacturer see info below:

Eurovema AB
Tel: +46 371 390 100
Fax: +46 371 189 82
E-post: info@eurovema.se
Baldersvägen 38
SE-332 35 Gislaved
Sweden
www.eurovema.se

MONTERING

- Öppna förpackningen och kontrollera att ingen transportskada har skett.
- Kontrollera även att leveransen stämmer överrens med beställningen.
- Stolen levereras med ryggstödet och armstöden omonterade!
- Montera dit armstöd och ryggstöd som bilden visar och drag åt vreden (1, 2).

TRANSPORT

Vid transport av Miniflex och Flexmobil i motorfordon är det viktigt att bromsarna är inkopplade. Se avsnitt om "Frikoppling av bromsar". Stolen bör spännas fast med spännband. Som tillbehör finns särskilda fästöglor att montera på rullstolen fästa banden i.

Rullstolen är inte konstruerad för att brukaren ska sitta i stolen vid transport. Genom att ta bort ryggstöd, armstöd och benstöd kan minska transportmått. Batterierna i rullstolen är slutna och av typen GEL och godkända för transport i flygplan.

MINSTA TRANSPORTMÅTT:

	Miniflex	Flexmobil
Längd	70 cm	82 cm
Bredd	59 cm	59 cm
Höjd	55 cm	55 cm
Vikt	54 kg	74 kg



ASSEMBLY

- Open the packing and check that no transport damage has occurred.
- Also check that the delivery harmonize with the order.
- The chair is delivered with backrest and armrest not mounted!
- Mount the backrest and the armrests as shown in the picture. Tighten knobs (1, 2).

TRANSPORTATION

When transporting Miniflex or Flexmobil in a motor vehicle it is important that the brakes are engaged. See section "Disengagement of brakes". The chair should be secured with tie down straps.

Special brackets to be mounted on the chair are available as accessories. The wheelchair is not designed for transport with the user seated in the chair. You can reduce the transport size by removing the armrest, backrest and the legrest. The batteries in the wheelchair are maintenance free and of the type GEL and approved for transport in aircrafts.

SMALLEST TRANSPORT SIZE:

	Miniflex	Flexmobil
Length	70 cm	82 cm
Width	59 cm	59 cm
Height	55 cm	55 cm
Weight	54 kg	74 kg



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs igenom bruksanvisningen noga innan stolen tas i bruk.
- Arbetsstolen är avsedd att användas på plant underlag i ett normalt inomhusklimat.
- Iakttag försiktighet vid justering av manuella sitsvinklingen sittandes i stolen, då det kan medföra risk för fall ur stolen.
- Upptäcks skador eller förändringar i stolens funktion ska serviceinstans (hjälpmedelsleverantör) genast kontaktas.
- Används stolen mycket bör den lämnas in till serviceinstans för översyn regelbundet.
- Var noga med att dra åt skruvar, vred och reglage ordentligt efter utförd justering.
- Ge akt på om skruvar eller delar blir lösa eller glappa på rullstolen då det kan påverka säkerheten. Kontakta serviceinstans.
- Service och underhåll bör utföras av utbildad personal.
- Endast originaldelar från Eurovema ska användas vid reparation.
- Överskrid inte angiven max brukarvikt på stolen.
- Undvik kontakt med skadade eller läckande batterier. Uttjänta batterier skall lämnas för återvinning.

SAFETY

- Carefully read the manual before using the wheel chair.
- The work chair is designed to be used on even surface in normal indoor climate.
- Be careful when adjusting the high backrest and neckrest seated. Could cause a risk of falling backwards.
- Be careful when adjusting the manual seat angle when seated. Could cause a risk of falling out of the chair.
- Immediately contact service if damages or change in function of the chair is discovered.
- If the chair is used frequently it should have service regularly.
- Make sure to tighten all screws, knobs and levers after adjustments.
- Immediately contact service if damages or change in function of the chair is discovered.
- Service and maintenance should be performed by educated staff.
- Use only original parts from Eurovema at repair.
- Do not exceed maximum user weight.
- Avoid contact with a damage or leaking battery. Used batteries should be recycled.

ÖVERSIKT

- 1) manöverbox
- 2) joystick
- 3) ladduttag
- 4) sits
- 5) ryggstöd
- 6) armstöd
- 7) sitslyft - ställdon
- 8) automatsäkring
- 9) drivhjul
- 10) kåpa
- 11) länkhjul
- 12) fotstöd - fotplatta
- 13) parallellbeslag

OVER VIEW

- 1) control box
- 2) joystick
- 3) charger socket
- 4) seat
- 5) backrest
- 6) armrest
- 7) seat lift - actuator
- 8) automatic fuse
- 9) drive wheels
- 10) covers
- 11) castors
- 12) leg support - footplate
- 13) parallel hardware



ELEKTRONIK

Miniflex och Flexmobil är eldrivna rullstolar som är utrustade med Dynamic styrsystem för att kontrollera kraften från batterierna ut till motorerna. Rullstolen och dess elektriska sitsfunktioner manövreras med hjälp av manöverboxen som finns i två olika utföranden: G90T och SHARK. Joystick används för att köra rullstolen i den riktning man önskar. Elektroniken kan programmeras för att anpassas till den enskildes önskemål, men oftast är originalprogrammet alldeles tillräckligt. Skulle något fel inträffa med elektroniken så blinkar statusdioden (8). genom att räkna antalet blink kan man härleda felet. Se kap. felsökning.

- 1) on/off
- 2) val av körprogram
- 3) batteriindikator
- 4) display av körprogram/hastighet
- 5) joystick
- 6) sitsfunktioner
- 7) symboler för sitsfunktioner
- 8) status diod
- 9) tuta




G90T

ELECTRONICS

Miniflex and Flexmobil are power wheelchairs equipped with Dynamic control system to control the power from the batteries out to the motors. The wheelchair and its power assisted seat functions is controlled by the control box, available in three different models; G90T och SHARK. The joystick is for driving the wheelchair in the desired direction. The electronics can be programmed to suit the users needs but usually the original program is fully sufficient. Should a fault occur with the electronics the status LED (8) will blink. Thru counting the number of blink you can deduce the problem. See chap. fault trace.

- 1) on/off
- 2) choice of drive programs
- 3) battery indicator
- 4) display for drive programs/speed
- 5) joystick
- 6) seat functions
- 7) symbols for seat functions
- 8) status LED
- 9) horn

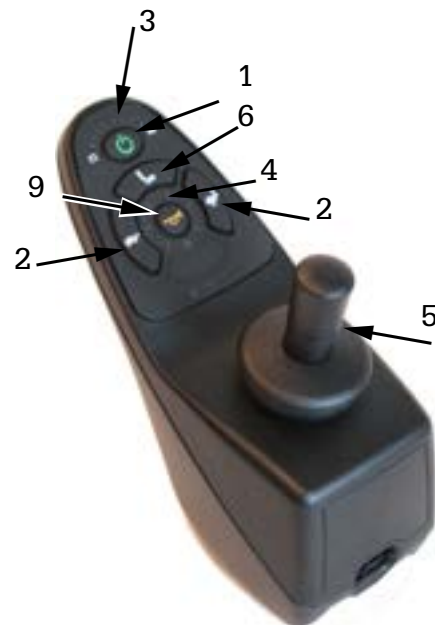

SHARK

RYGGSTÖD - sittdjup

För att justera sittdjupet med ryggstödet används vreden (1). Justera in önskat sittdjup genom att föra ryggstödet framåt eller bakåt. För spaken till sitt ursprungsläge för att låsa.

RYGGSTÖD - vinkel

För att justera vinkeln på ryggstödsplattan används spaken (2). Justera in önskad vinkel och lås genom att föra tillbaka spaken till sitt ursprungsläge.

BACK REST - seat depth

To adjust the seat depth you can move the back support forward or backwards. Use the wheel nut (1). Adjust the desired seat depth by moving the back support forward or backwards. Lock by moving the lever to its original position.

BACK REST - angle

To adjust the angle on the back support, loosen the lever (2). Adjust to desired angle and lock by moving the lever back to its original position.



svenska


RYGGSTÖD - höjd

Lossa på spaken (1) genom att vrida den moturs $\frac{1}{2}$ varv. Ställ in önskat höjd på ryggstödet och vrid spaken medurs $\frac{1}{2}$ varv för att låsa.

english

BACK REST - height

Loosen the lever (1) by turning it anticlockwise $\frac{1}{2}$ turn. Adjust to desired height of the back support and lock turning the lever clockwise $\frac{1}{2}$ turn.

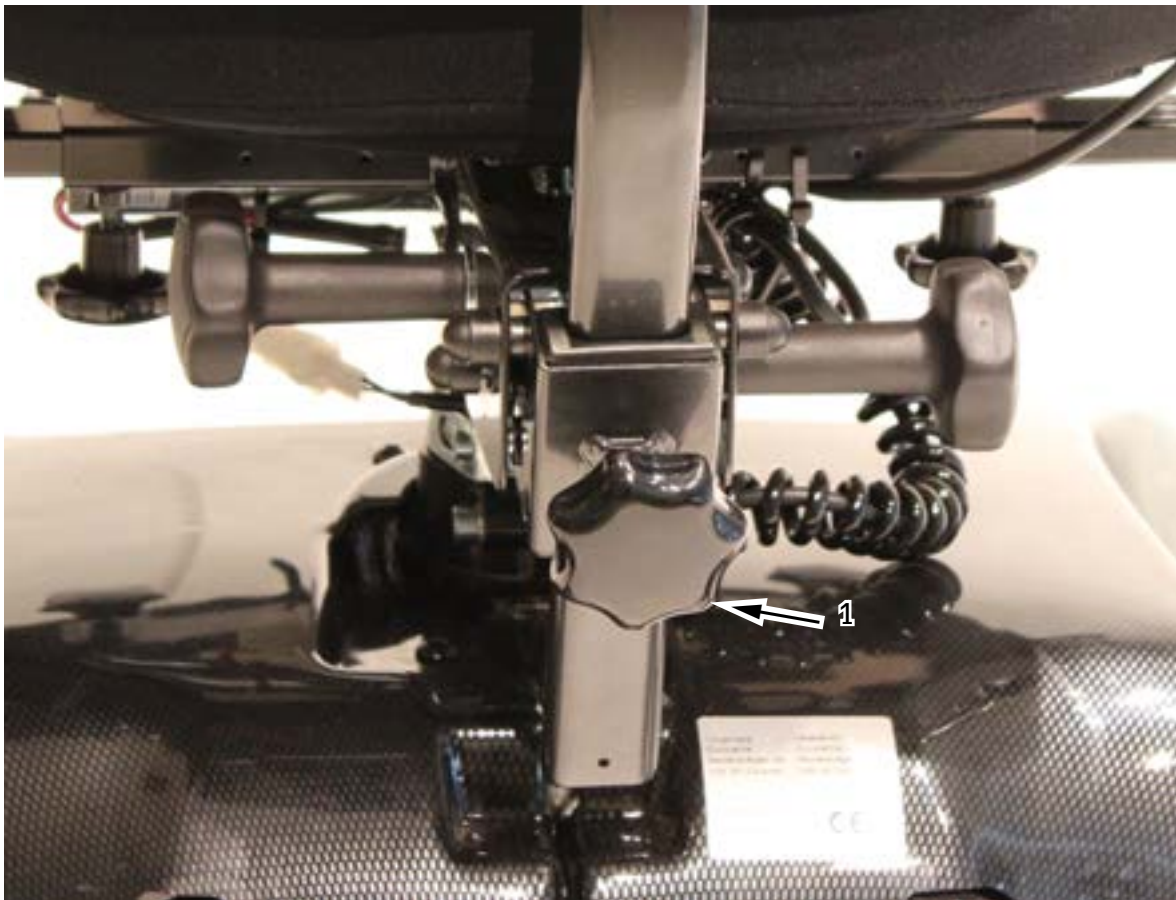

SITSVINKEL - manuell

Sitsvinkeln är möjlig att justera från 0° till -20° framåt. För att justera vinkeln lossas spaken (1) genom att trycka i pilens riktning. Justera in önskad sittvinkel. Lås genom att föra tillbaka spaken till sitt ursprungsläge.

**FALLRISK!**

OBS! När spaken (1) lossas så blir sitsvinklingen lös och sitsen kan snabbt falla framåt om man sitter i stolen. Iakttag försiktighet vid justering!

SEAT ANGLE - manual

The seat angle is possible to adjust forward 0° to -20°. To adjust the angle loosen the lever (1) pushing in the direction of the arrow. Adjust to desired angle and lock by moving the lever to its original position.

**RISK OF FALLING!**

NOTE! When the lever (1) is pushed down the seat angle mechanism is loose and the seat can tilt forward rapidly if you are seated. Be careful when adjusting the seat angle.



SITSVINKEL - elektrisk

Om stolen är utrustad med elektrisk sitsvinkling/tilt aktiveras denna med manöverboxen. Tryck på knapp "6" på manöverboxen.


G90T

Välj sitssymbol (7) för sitsvinkling genom att föra joystick (5) åt sidan till andra symbolen från vänster sida blinkar.

SHARK

Välj sitssymbol (6). Tryck på sitssymbol (6) och välj siffran "2".

För sedan joystick (5) framåt för att vinkla sitsen framåt, och bakåt för att vinkla sitsen bakåt. Sitsvinklingen stannar automatiskt när ändlägena nås. För att återgå till körläge tryck på knapp (2) så att valt körprogram syns i display (4).

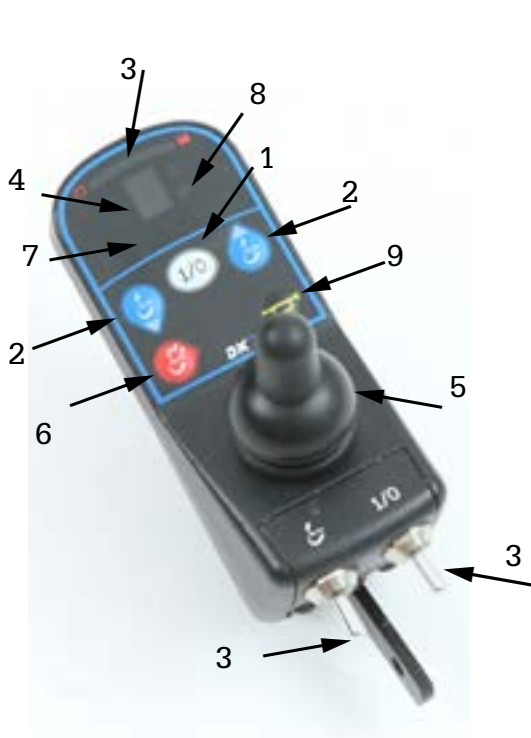

G90T

SEAT ANGLE - power

If the chair is equipped with power assisted seat tilt it's activated by the controlbox. Push button "6".


G90T

Choose a seat symbol (7) for the seat angle by moving the joystick (5) to one side to the second icon from the left side blinks.

SHARK

Choose a seat symbol (6). Press the seat symbol (6) and select the number "2".

Move the joystick forward to activate the seat tilt forward and backwards for backwards. The seat tilt stops automatically when the endpoints is reached. Push button (2) to get back into drive mode and the choosed drive program will be visible in the display (4).

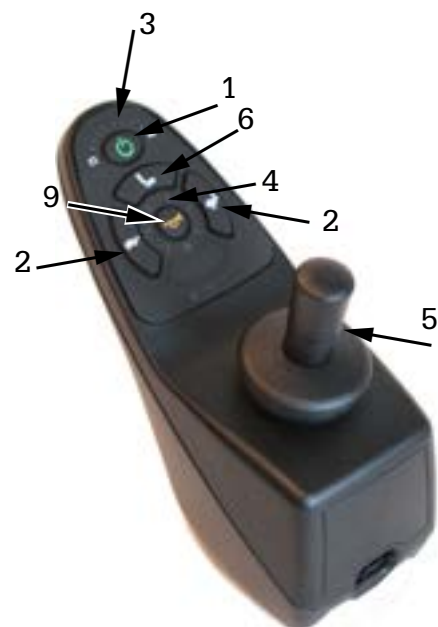

SHARK

SITSHÖJD

Starta elektroniken på rullstolen genom att trycka på knapp (1) på manöverboxen. Tryck sedan på knapp (6).

G90T

Välj sitssymbol "7" och drag joysticken åt sidan för att välja fjärde symbolen från vänster. För sitslyft genom att föra joystick (5) åt sidorna tills symbolen blinkar.

Shark

Siffran "1" lyser på knapp (6). För sedan joystick (5) framåt för att höja sitsen och bakåt för att sänka sitsen. Sitslyften stannar automatiskt när ändlägena nås. För att återgå till körläge tryck på knapp (2) så att valt körprogram syns i display (4).

SEAT HEIGHT

Start the electronics of the wheel chair by pushing button (1) on the control box. Then push button (6).

G90T

Choose a seat symbol "7" and pull the joystick to the side to select the fourth icon from the left. For seat lift thro leaning the joystick (5) side ways until the symbol blink.

Shark

The nubmer "1" lights up on button (6). Move the joystick forward to activate the seatlift up and backwards down. The seat lift stops automtically when the endpoints is reached. Push button (2) to get back into drive mode and the choosed drive program will be visble in the display (4).



G90T

SHARK

ARMSTÖD - höjd och bredd

För att justera bredden mellan armstöden lossas ratten (1). Justera till önskad bredd och drag åt ratten. Gör likadant på det andra armstödet. Justera höjden på armstödet genom att lossa spaken (2). Justera in önskad höjd och drag åt spaken.



TILLVAL!

ARMSTÖD - fälla bakåt

Om rullstolen är utrustad med fällbara armstöd så går det att fälla bakåt för att underlätta sidoförflyttning och möjligheten att komma nära ett bord till exempel. Tryck spaken (3) nedåt i pilens riktning för att fälla bakåt. För att fälla tillbaka armstödet lyfts det med handen till upprätt läge där det låses automatiskt.

ARM REST - height and width

To adjust the width between the arm supports, loosen the wheel nut (1). Adjust to desired width and tighten the wheel. Repeat on the other arm support. Tighten the wheel nuts. To adjust the height of the arm support, loosen the wheel lever (2). Adjust to desired height and tighten the wheel lever.



OPTION!

ARM REST - fold back

It is possible to fold the arm support backwards to make sideways transfer easier or to get closer to a table. Push lever (3) in the direction of the arrow to fold the arm support backwards. To get it back to upright position, use your hand to lift it up where it locks automatically.



MANÖVERBOX - justering

Manöverboxens läge kan justeras genom att lossa skruvarna 1, 2 och 3 med insexnyckel 5 mm. Lossa skruv 1 för att justera i djupled och 2, 3 för att justera manöverboxen i vinkel och höjd. Justera in önskat läge och drag åt skruvarna. Manöverboxen kan även parallellt förflyttas åt sidan och bakåt för att vara ur vägen när man till exempel vill komma nära ett bord.

CONTROLBOX - Adjustments

The controlbox position can be adjusted by loosening the screws 1,2 and 3 with allen key nr 5. Loose screw 1 to adjust in depth and screw 2 and 3 to adjust angle and height. Adjust to desired position and tighten the screws. The controlbox can also be swung away when you would like to get close to a table i.e.



**TILLVAL!****NACKSTÖD - justera**

Om stolen är utrustad med ett nackstöd så justeras det genom att lossa på skruvarna och rattarna (1, 2, 3) för att justera in höjd, djup och vinkel på nackstödet. Lås nackstödet genom att föra tillbaka spakarna till låst läge.

**FALLRISK!**

OBS! När spakarna (1 och 3) lossas så blir nackstödet löst och kan snabbt falla bakåt om man sitter i stolen. Iakttag försiktighet vid justering!

**OPTION!****NECK REST - adjust**

If the chair is equipped with a neck support its adjusted by the screw and wheels (1, 2, 3) to adjust to desired position. Move the levers back to the original position to lock.

**RISK OF FALLING!**

NOTE! When the lever (1 and 3) is opened the neck support come loose and can rapidly fall backwards if you are seated in the chair. Be careful when adjusting the neck support!



BENSTÖD - hel fotplatta

Om stolen är utrustad med hel fotplatta så justeras den i höjd och underbensvinkel genom att lossa skruvar (1 och 2) med insexnyckel 5 mm. Justera till önskat läge och drag åt. För att justera djup och fotplattans vinkel lossas skruvar (3 och 4). Ställ in önskat läge och drag åt. Fotplatta är även uppfällbar för att underlätta vid förflyttning till och från stolen.



TILLVAL! (ingen bild)

BENSTÖD - delade fotplattor

Om stolen är utrustad med delade fotplattor så justeras dessa i höjd och underbensvinkel genom att lossa skruvar med insexnyckel 5 mm. Justera till önskat läge och drag åt. För att justera djup och fotplattans vinkel lossas skruvar. Ställ in önskat läge och drag åt. För att justera fotplattans läge i sidled lossas vred. Justera in önskat läge och drag åt vredet. Fotplatta är även uppfällbar för att underlätta vid förflyttning till och från stolen.

**LEG REST - single footplate**


If the chair is equipped with a single footplate you can adjust the height and lower leg length by loosening screw (1 and 2) with allen key 5 mm. Adjust to desired position and tighten the screws. To adjust depth and the angle of the footplate loosen screws (3 and 4). Adjust to desired position and tighten the screws. The footplate is possible to fold up to make it easier to get in and out of the chair.



OPTION! (no picture)

LEG REST - divided footplate

If the chair is equipped with divided footplates it's adjusted in height and lower leg angle by loosening screws. Adjust to desired position and tighten the screws. To adjust depth and angle of the footplate loosen screw. Adjust to desired position and tighten the screws. To adjust the legrest position sideways loosen the knob. Adjust to desired position and tighten the knob. The footplate is possible to fold up to make it easier to get in and out of the chair.

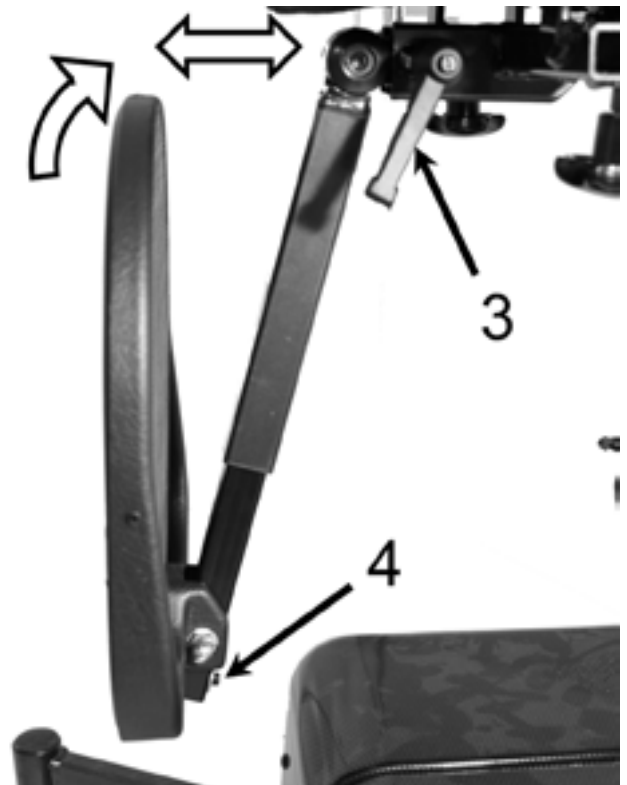

KÖRNING

Sätt er så bekvämt som möjligt i stolen och låt den arm ni ska manövrera rullstolen med vila mot armstödet så att handen får ett bekvämt grepp om joystick (5). Starta elektroniken på rullstolen genom att trycka på knapp (1), vänta ett par sekunder tills batteriindikatorn (3) slutat blinka.

G90T/SHARK

Välj önskat körprogram (1, 2 eller 3) med knapparna (2), där 3 är det snabbaste. Ju fler gröna lampor desto fortare går stolen. Luta nu joystick försiktigt åt det håll ni önskar åka och rullstolen åker dit. Ju mer joystick lutas desto fortare går rullstolen. Släpp joystick och rullstolen stannar omedelbart. Denna rullstol är avsedd för enbart inomhusbruk och konstruerad för att klara hinder på upp till 3 cm. Dessa hinder bör köras över med framhjulen parallellt med hindret.



SKADERISK!

OBS! Se till att det finns mycket gott om plats runt rullstolen vid körning första gången. Öva på att backa, svänga och köra på olika hastigheter för att bli bekant med hur rullstolen uppför sig i olika situationer. Var försiktig vid passering av hinder som trösklar och liknande.



DRIVING

Place yourself as comfortable as possible in the chair and let the arm you should use to control the wheelchair rest on the armrest so that your hand can grip the joystick (5) comfortable. Start the electronics by pushing button (1), wait a couple of seconds until the batteryindicator (3) has stopped twinkle.


G90T/SHARK

Choose desired driveprogram (1,2 or 3) with the buttons (2), where 3 is the fastest. The more LEDS the faster the wheelchair goes. Now lean the joystick at the direction you wish to go and the wheelchair goes there. Release the joystick and the wheelchair will stopp immediately. This wheelchair is intended for indoor use only and designed to climb obstacles not higher than 3 cm. These obstacles should be passed with the front wheels parallell to the obstacle.



RISK OF INJURE!

NOTE! Make sure that you have a lot of free space around the wheelchair when driving the first time. Practice to drive backwards, turning and forward at different speed to get familiar how the wheelchair behave at different situations. Be careful when passing obstacles like thresholds or similar.

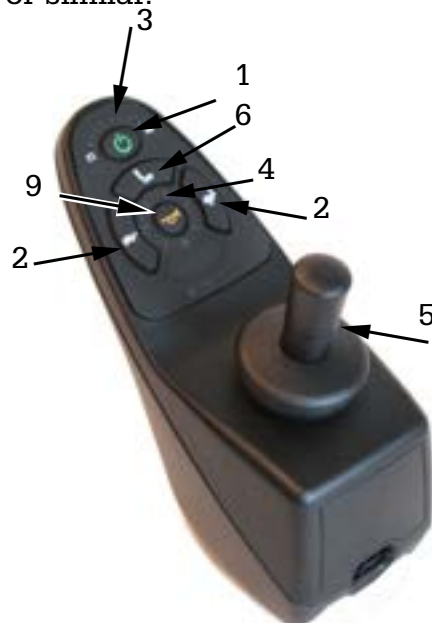

SHARK

FRIKOPPLING AV BROMSAR

För att kunna transportera rullstolen rullande med elektroniken avstängd måste man koppla ur bromsarna/motorerna. Det gör man genom att stänga av elektroniken och fälla upp den röda spaken som sitter vid chassi benet vid det bakre länkhjulet (1). Nu kan man transportera stolen utan att motorerna bromsar. För att återgå till körning fäller tillbaka den röda spaken och startar elektroniken.

Om man startar elektroniken när bromsarna är urkopplade kommer det att orsaka ett felmeddelande på manöverboxen. Stäng av elektroniken koppla in bromsarna och starta om stolen, så försvinner felmeddelandet.



SKADERISK!

OBS! Se till att rullstolen står på plan mark när bromsarna kopplas ur. Annars kan rullstolen rulla iväg utan kontroll.

DISENGAGEMENT OF BRAKES

To be able to transport the wheelchair without using the electronics you need to disengage the brakes/motors. This is done by turning off the electronics and lift the red lever placed on the chassi leg by the rear castor (1). Now you can transport the wheelchair without motor brakes. To get back into driving you fold the red lever back to its original position and starts the electronics.

If you start the electronics when the brakes are disengaged it will cause an error code on the controlbox. Turn off the electronics engage the brakes and restart the electronics, the error code will disappear.



RISK OF INJURE!

NOTE! Make sure that the wheelchair is on flat ground when disengaging the brakes. Otherwise the wheelchair can start rolling away without control.



AUTOMATSÄKRING

Automatsäkringen är placerad bak på vänster kåpa på Flexmobil (2) och fram mellan kåporna på Miniflex (1). Säkringen löser ut om något allvarlig elektrisk fel inträffar på rullstolen. Knappen åker ut ca 8 mm och ett vitt streck blir synligt. Säkringen kan även användas som huvudströmbrytare. Vid längre tids förvaring bör säkringen vara i utlöst läge.



NOTERA!

OBS! När batterierna ska underhållsladdas måste säkringen vara intryckt! Vid transport i flygplan krävs oftast att batterierna ska vara frånkopplade och då kan man använda automatsäkringen, som ska vara utlöst, i detta fall.

AUTOMATIC FUSE


The automatic fuse is placed on the rear cover on Flexmobil (2) and in the front between the covers on Miniflex (1). The fuse will disengage if a severe electrical failure occurs on the chair. The button pops out approx. 8 mm and a white line becomes visible.

The automatic fuse can be used as main power switch. When the wheelchair is stored for a longer period the fuse should be disengaged.



NOTE!

When the batteries is charged the fuse must be engaged. For transport in a aeroplane the batteries usually must be disconnected and for this you can use the automatic fuse that should be disengaged.

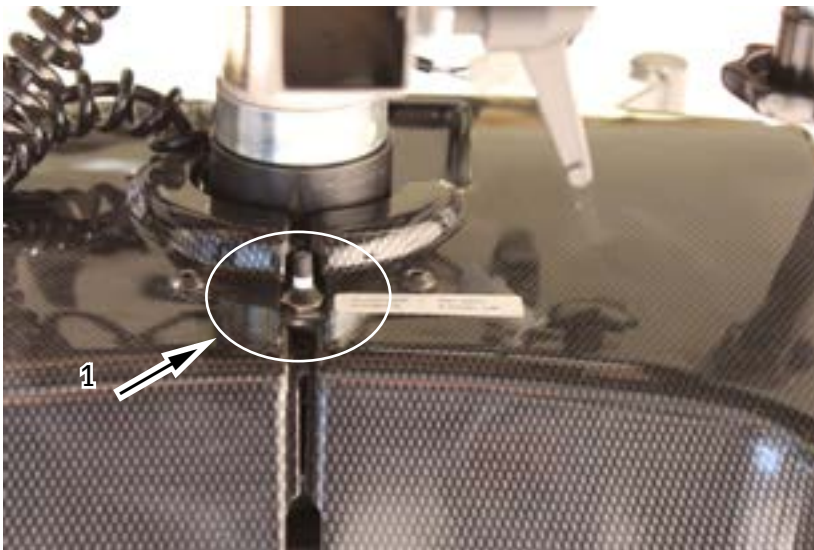

LADDNING AV BATTERIER

För att erhålla batteriernas fulla prestanda så länge som möjligt är det viktigt att de laddas regelbundet, lämpligen laddar man batterierna varje natt om stolen använts på dagen. Avbryt ej laddningen innan den är färdig. Laddning kan ske inomhus i bostaden utan problem.

Vid förvaring bör batterierna laddas cirka en gång i månaden för att ej tömmas till den kritiska nivån då laddaren ej längre startar laddningen. Lämna ej laddningen på långa perioder utan avbrott då detta ej är bra för batterierna.



OBS!

Om batterierna är skadade eller läcker bör all kontakt undvikas med dessa för att undvika frätskador. Kontakta snarast behörig verkstad! Förbrukade batterier bör lämnas till återvinning

1. Anslut laddkontakten till manöverdosan på stolen. Den sitter framtill på manöverdosan. Se bild.
2. Anslut laddarens väggkontakt.
3. Kontrollera med hjälp av laddarens kontrollampor att laddningen startat. Uppgifter angående laddaren bifogas med laddaren.
4. När laddning är klar stängs laddaren av eller väggkontakten dras ur och därefter laddkontakten i manöverdosan.

CHARGING OF BATTERIES

To keep the full power of the batteries as long as possible it is important to charge them regularly, as a suggestion at night if the chair is used during daytime. Never stop the charging until its completed. Charging can take place indoors in the living area without problems. When stored the batteries should be charged once a month to prevent them to go under the critical level when the charger cannot start. Do not leave the recharging on for long continuous periods as this is not good for the batteries.



NOTE!

If the batteries are damaged or leak, all contact with these should be avoided to prevent corrosive injuries. Contact an authorised workshop as soon as possible! Used batteries should be handed in for recycling.

1. Connect the charger plug to the control box on the chair. Located in the front of the controlbox. See picture.
2. Connect the charger to the wall socket.
3. Check on the charger's indicator lamps that recharging has started. Information on the charger is supplied with the charger.
4. When recharging has been completed, switch off the charger or remove the plug from the wall socket and then the charger plug from the control box.



SERVICE

Om rullstolen används mycket d.v.s. varje dag bör den lämnas in på service för översyn en gång per år. Detta för att kontrollera att funktionen och säkerheten på rullstolen bibehålls under hela dess livslängd. Vid behov av service kontaktas i första hand den lokala Hjälpmedelscentralen.

GARANTI

Vi lämnar 2 års garanti på våra produkter för tillverkningsfel/skada. Undantag för klädsel, hjul och batterier där vi lämnar 1 års garanti. Normalt slitage ligger inte till grund för godkänd garanti. Vi rekommenderar våra kunder att använda produkten i enlighet med bruksanvisningen.

CE - märkning

Denna produkt är CE – märkt enligt direktiv 93/42/EEC. CE märket finns på etiketten. Provad och godkänd enligt direktiv SSEN1335–1,2, 3. Brandtestad enligt ISO7176-16.

SERVICE

If the wheel chair is used frequently, i.e. every day, it ought to have service once a year. This to control that the function and security of the wheel chair is kept through all its lifetime. If service is needed contact primarily your local dealer.

WARRANTY

We give a 2 year warranty on our products for fabrication fault/damage. Exceptions are fabric, wheels and batteries where we give 1 year warranty. A normal wear and tear is not accepted as a warranty. We urge our customers to use the products according to the manual

CE - label

This product has the CE – mark according to the directive 93/42/EEC. The CE mark is on the label. Tested and approved according to directive SSEN1335–1,2, 3. Firetested according to ISO7176-16.

RENGÖRING:

Torka av rullstolens ytor med en lätt fuktad trasa med ett mildt rengöringsmedel, typ diskmedel. Stolen placeras på plant underlag under torkning. Sitsens klädsel kan rengöras med de medel som finns på marknaden för klädseltvätt. Överdragsklädsel kan maskintvättas i 60 grader.

FUNKTION:

Upptäcks lösa skruvar eller glapp i någon del av stolen eller förändrade köregenskaper skall detta omedelbart åtgärdas då det kan påverka säkerheten. Kontakta lokal Hjälpmedelscentral eller tillverkaren för hjälp och frågor.

Var noga med att alltid dra åt vred eller skruvar efter utförda sjusteringar.

FÖRVARING:

Om rullstolen ska förvaras under en längre period utan att användas (en månad eller mer) bör den förvaras i ett rent, fuktfritt rumstempererat utrymme. Batterierna bör laddas ca. en gång i månaden för att ej tömmas till den kritiska nivån då laddaren ej längre startar laddningen.

CLEANING:

Wipe the surface of the wheelchair with a damp cloth with a mild detergent. Place the chair on plain surface for drying. The upholstery can be cleaned with any existing brands on the market. Covers can be machine washed in 60 degrees Celsius.

FUNCTION:

If loose screws or loose parts is discovered somewhere on the wheelchair or a change in drive characteristic, immediate repair should take place when this could affect safety. Contact your local agent or the manufacturer for help and questions.

Be sure to tighten all screws and knobs after seat adjustments.

STORAGE:

If the wheelchair should be unused for a longer period (a month or more) it should be stored in a clean, dampfree room tempered space. The batteries should be charged once a month to prevent them to go under the critical level when the charger cannot start.

TEKNISKA FAKTA

TECHNICAL DATA

	Fakta. Data	
Klass	A	Class
ISO	122127	ISO
Chassi	Miniflex/Flexmobil	Chassis
Drivning Miniflex	Framhjul. Front wheel	Drive Miniflex
Drivning Flexmobil	Centralhjul. Central wheel	Drive Flexmobil
Hindertagning	3 cm	Obstacle climbing
Markfrigång	6 cm	Ground clearance
Totallängd - inkl. fotplatta	Miniflex 90 cm Flexmobil 106 cm	Total length - incl. footplate
Totallängd - chassi	Miniflex 72 cm Flexmobil 82 cm	Total length - chassis
Totalbredd - chassi	Miniflex 59 cm Flexmobil 58 cm	Total width - chassis
Totalvikt	Miniflex 54 kg Flexmobil 74 kg	Total weight
Vändutrymme	Miniflex 120 cm Flexmobil 96 cm	Turning space
Drivhjul	Miniflex 20 cm Flexmobil 22,5 cm	Drive wheels
Länkhjul	12,5 cm	Castors
Hastighet-max	4 km/h	Speed - max.
Körtid/laddning - max.	8,5 h	Driving time / charge - max.
Batterier	Miniflex 2x12V-20Ah Flexmobil 2x12V-25Ah	Batteries
Elektronik	Dynamic	Electronics
Sits BxD	40x40, 40x43, 40x46, 46x46, 49x51 cm	Seat, sizes WxD
Sitsbredd mellan armstöd	40-59 cm	Seat, width between armrest
Sitsdjup, från rygg till sits framkant	29-54 cm	Seat, depth -from back to seat front
Sitshöjd - kort ställdon, Miniflex	43-61 cm +5 cm *	Seat, height - short actuator
Sitshöjd - kort ställdon, Flexmobil	42-60 cm +5 cm *	Seat, height - short actuator
Sitshöjd - långt ställdon, Miniflex	49-74 cm +5 cm *	Seat, height - long actuator
Sitshöjd - långt ställdon, Flexmobil	48-73 cm +5 cm *	Seat, height - long actuator
Sitsvinkling, manuell, framåt	0° - -20°	Seat, angle, manual, forward
Sitstilt, el, framåt-bakåt	-14° - +17°	Seat, tilt, power, forward-backward
Ryggstöd, storlek, BxH	35x30, 35x44, 40x30, 40x44 cm	Back, size, std WxH
Ryggstöd, höjd från sits	43-62 cm	Back, height from seat
Nackstöd, storlek	21x23 cm	Neckrest, size
Klädsel, färger	Svart. Black	Upholstery, color
Armstöd, höjd	19-25 cm	Armrest, height
Armstöd, platta, storlek	31x8 cm	Armrest, plate, size

*Steglöst inställbar.

*Adjustable between min and max (actuators).

FELSÖKNING

Problem?	Åtgärd!
Rullstolen startar inte?	
Automatsäkringen är utlöst?	Kontrollera automatsäkringen - se manual!
Batterierna är urladdade?	Ladda batterierna - se manual!
Glapp i kablar?	Kontakta Hjälpmedelscentralen!
Batterierna tar inte emot laddning?	
Automatsäkringen är utlöst?	Kontrollera automatsäkringen - se manual!
Batterierna är helt urladdade?	Kontakta Hjälpmedelscentralen!
Laddaren är trasig?	Kontakta Hjälpmedelscentralen!
Batteriindikatorn sjunker snabbt trots nyladdade batterier?	
Batterier börjar bli dåliga?	Kontakta Hjälpmedelscentralen!
Fel i elektroniken?	Kontakta Hjälpmedelscentralen!
Statusdioden blinkar på manöverboxen?	
Elektroniken har startats när stolen har frikopplade bromsar?	Stäng av och koppla in bromsarna - se manual!
Något fel har uppstått på rullstolen?	Kontakta Hjälpmedelscentralen!
Rullstolen går långsamt?	
Är rätt körprogram valt?	Välj ett snabbare körprogram - se manual!
Rullstolen orkar inte köra eller svänga över hinder?	
Ett för långsamt körprogram har valts?	Välj ett snabbare körprogram - se manual!

english

FAULT TRACE

Problem?	Action!
The wheelchair doesn't start?	
The automatic fuse is released?	Check the fuse - see the manual.
The batteries is discharged?	Charge the batteries!
Loose cables?	Contact service!
The batteries can not be charged?	
The automatic fuse is released?	Check the fuse - see the manual
The batteries is totally discharged?	Contact service!
The charger is broken?	Contact service!
Battery indicator drops quickly despite charged batteries?	
The batterier starts getting bad?	Contact service!
Error in the electronics?	Contact service!
The status LED is blinking on the controlbox?	
Electronics has been started when brakes are disengaged?	Turn off and engage the brakes- see the manual!
An electric fault has occurred on the wheelchair?	Contact service!
The wheelchair is running slow?	
Is the right drivprogram selcted?	Select a quicker driveprogram- see the manual!
The wheelchair don't manage to climb obstacles?	
A too slow driveprogram is selected?	Select a quicker driveprogram- see the manual!

Eurovema
Creates mobility and ergonomics.